



زمان بازنگری: تغییر دستورالعمل

تاریخ صدور: ۰۱/۱۱/۱۲

تعداد صفحات: ۱ از ۲

شماره سند: ۹۸-۱۹۹۷

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: بخش کنترل کیفیت



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

نوعه دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۳۰

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱،۱۸۲



پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive		CL		Positive
HCV Ab	Negative		ELFA		Negative
HIV Ab	Positive		CL		Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
------	--------	----	-----	------	-------	--------



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

نوعه دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۳۱

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱،۱۸۲



پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative		CL		Negative
HCV Ab	Negative		CL		Negative
HIV Ab	Positive		CL		Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
------	--------	----	-----	------	-------	--------

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مطهره کریم زادگان
متخصص بائیولوژی
۳۵۷-۸



زمان بازنگری: تغییر دستورالعمل

تاریخ صدور: ۰۱/۱۱/۱۲

تعداد صفحات: ۲ از ۲

شماره سند: ۹۸-۱۹۹۷

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: بخش کنترل کیفیت



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: IF-۱۳۳۳

آزمایشگاه: سینا ۲۷۱۱۸۲



ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۱۲۸+	پاستور	۱/۶۴+ - ۱/۲۵۶+
۳	گومیس رایت	۱/۲۵۶+	پاستور	۱/۶۴+ - ۱/۲۵۶+
۴	YME	۱/۱۲۸+	پاستور	۱/۳۲+ - ۱/۱۲۸+



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت BK

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: IF-۱۴۴۴


آزمایشگاه: سینا ۲۷۱۱۸۲



تشخیص آزمایشگاه: ++

تشخیص مورد انتظار: ++

نمودار فراوانی نتایج

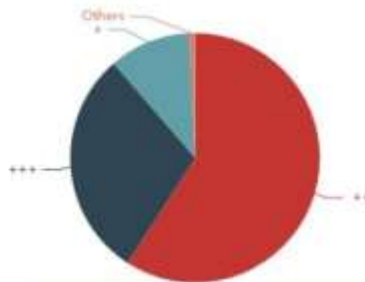

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مطهره کریم زادگان
متخصص باتوبیولوژی
۳۵۲-۸